


Ветеринарна клініка Ігровий набір. BD37390Z

Встановлення та заміна батарейок

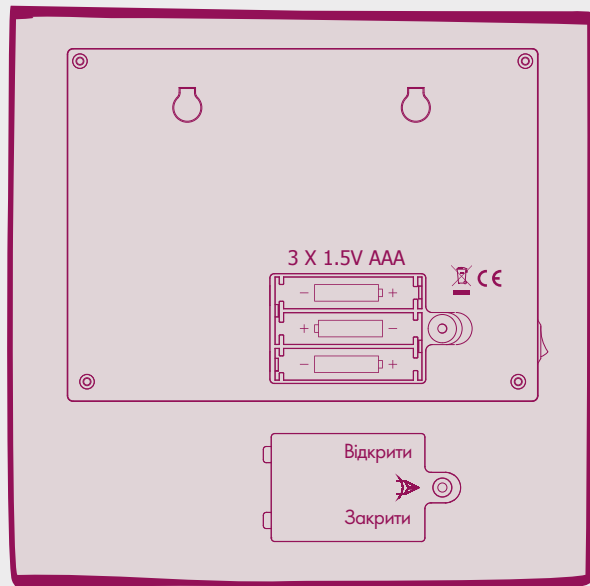


За допомогою викрутки відкрийте відсік для батарейок.

Встановіть 3 батарейки AAA 1.5 В, дотримуючись полярності.

Закрийте відсік, закрутіть гвинти.

Встановіть перемикач живлення у позицію «ON» (увімкнено).

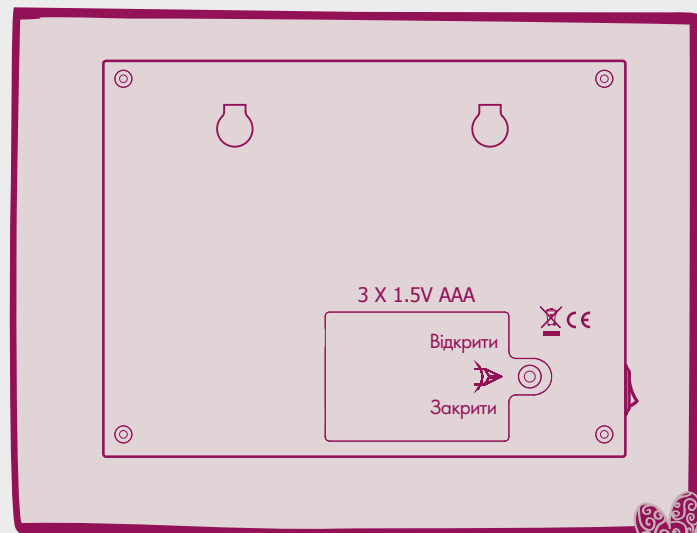


ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Не призначено для дітей віком до 36 місяців.
Використовувати під безпосереднім наглядом дорослої особи. Містить дрібні елементи – ризик задиху.

3+

Ветеринарна клініка

Опис режимів

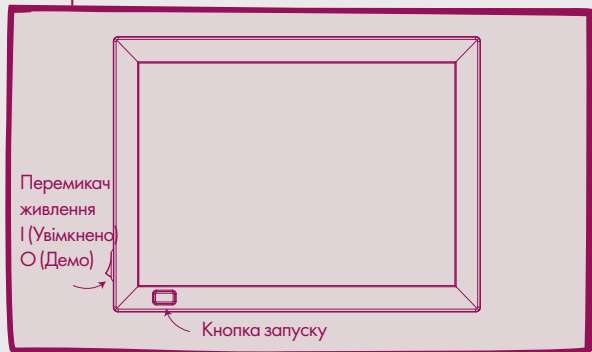

Режим «ON» (Увімкнено)

1. Встановіть перемикач у позицію «I», щоб увімкнути підсвічування. Підсвічування автоматично вимикається за 3 хвилини з метою збереження рівня заряду батарейок.
2. Встановіть перемикач у позицію «O», щоб вимкнути підсвічування у будь-який момент.
3. Щоб знову активувати підсвічування, встановіть перемикач у позицію «I».

Режим «Демо»

1. Натисніть кнопку запуску для увімкнення підсвічування на 3 секунди.

Батарейки можуть містити хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином, у спеціально відведених для цього місцях.

УВАГА!

3 x AAA 1.5 В батарейки входять до комплекту.

Не використовуйте одночасно старі та нові батарейки.

Не використовуйте одночасно лужні, сольові (вуглець-цинкові) та акумуляторні (нікель-кадмієві) батарейки.

Не кидайте батарейки у вогонь. Неправильне поводження із батарейками може призвести до вибуху або витoku електроліту. Виймайте батарейки з іграшки під час транспортування або коли вона не буде використовуватися протягом тривалого часу.

